bond.lign
«бонд.лайн»

secure natural beauty

Цемент DTK

Цемент DTK двойного отверждения делает возможным долговечное и надежное сцепление между любыми протезными материалами. Оптимальное средство для фиксации индивидуальных абатментов. – Теперь с возможностью стерилизации.

Гигиена | благодаря возможности стерилизации бактериальное загрязнение исключается

Универсальность | интраоральное и экстраоральное применение

Надежность | оптимальные характеристики сцепления в течение длительного времени

bredent group

Цемент DTK

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ БОНДИНГА

НЕПРОЗРАЧНЫЙ ЦЕМЕНТ DTK, 1 ШТ.
ПРОЗРАЧНЫЙ ЦЕМЕНТ DTK, 1 ШТ.
ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ K, 1 ШТ.
VISIO.LINK «ВИЗИО.ЛИНК», 1 ШТ.
ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ MKZ, 1 ШТ.
СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАНЮЛЯ С ИНТРАОРАЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, 10 ШТ.
ПЛАСТИКОВАЯ ЧАША SILANO PEN «СИЛАНО ПЕН», 12 ШТ.
ИЗОЛЯНТ ФГП, 1 ШТ.
ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ M1,4, 2 ШТ.
БЛОК ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ, 1 ШТ.
ДЕРЖАТЕЛЬ КИСТОЧКИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ПРЯМОЙ, 1 ШТ.
ОДНОРАЗОВАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ КИСТОЧКА, 10 ШТ.

REF 5400BOND (bredent)
REF 5800BOND (bredent medical)

Цемент DTK непрозрачный

Двойной смесительный картридж
с непрозрачным цементом DTK, 1 шт. на 8 г
Смесительная канюля, 10 шт.
Поршень шприца, 1 шт.
Держатель одноразовой кисточки, 1 шт.
Одноразовая кисточка, 10 шт.

REF 540 0128 5

Прозрачный цемент DTK

Двойной смесительный картридж
с цементом DTK, 1 шт. на 8 г
Смесительная канюля, 10 шт.
Поршень шприца, 1 шт.
Держатель одноразовой кисточки, 1 шт.
Одноразовая кисточка, 10 шт.

REF 540 0118 5

Непрозрачный цемент DTK для фиксации абатментов

Двойной смесительный картридж
с непрозрачным цементом DTK, 1 шт. на 8 г
Грунтовочный состав MKZ, 1 шт.
Изолянт ФГП, 1 шт.
Фиксирующий винт, 2 шт.
Смесительная канюля, 10 шт.
Поршень шприца, 1 шт.
Держатель одноразовой кисточки, 1 шт.
Одноразовая кисточка, 10 шт.

REF 540 0127 5

- Не содер[illegible]ая амин-пероксид система без изменения цвета и с весьма незначительным водопоглощением.
- Долговечность сцепления составляет 2 года при комнатной температуре.
- Несмотря на отверждение без фотополимеризации обеспечивается полная прочность сцепления.

Клинически испытано Йенским университетом*

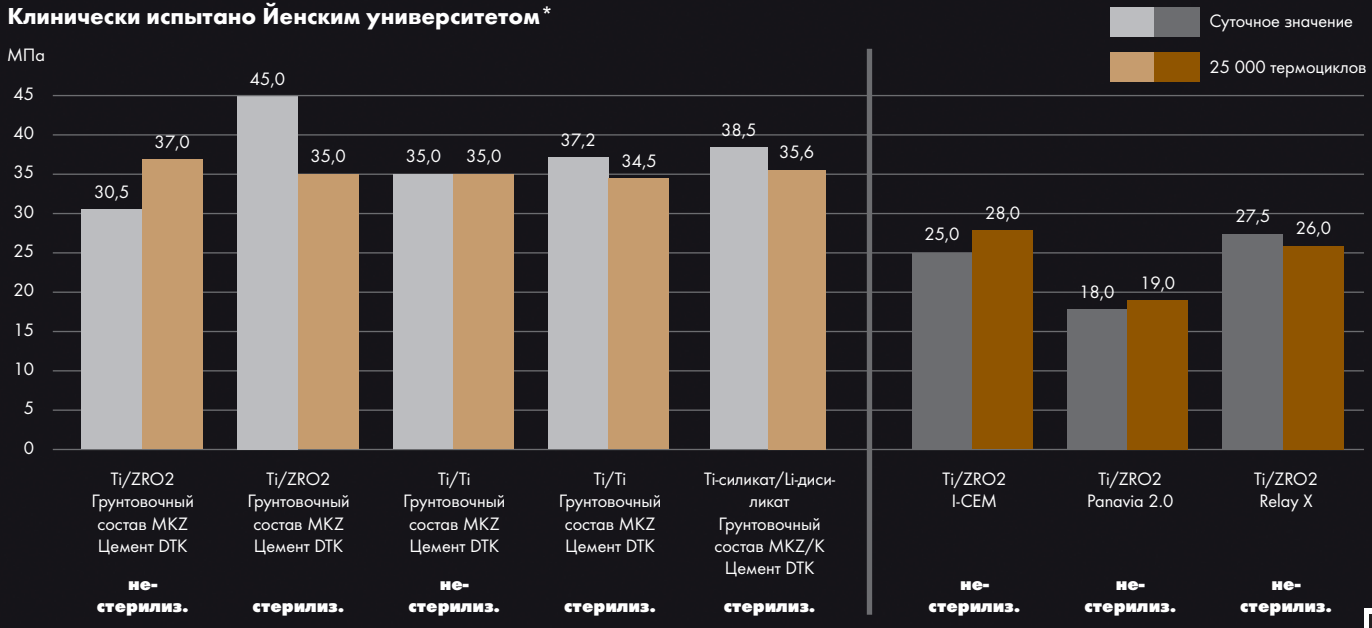

*R. Göbel, A. Rzanny: «Werkstoffkundliche Untersuchungen an dualhärtenden Befestigungswerkstoffen» («Материаловедческие исследования с фиксационными веществами»), подготовленный Йенским университетом отчет об исследовании от 11.06.2012, актуализирован 08.03.2017.

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений. 009893RU-20170228

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
bredent GmbH & Co. KG . Weissenhorner Str. 2 . 89250 Senden . Германия . Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 . Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 . www.bredent.com . Эл. почта: info@bredent.com